

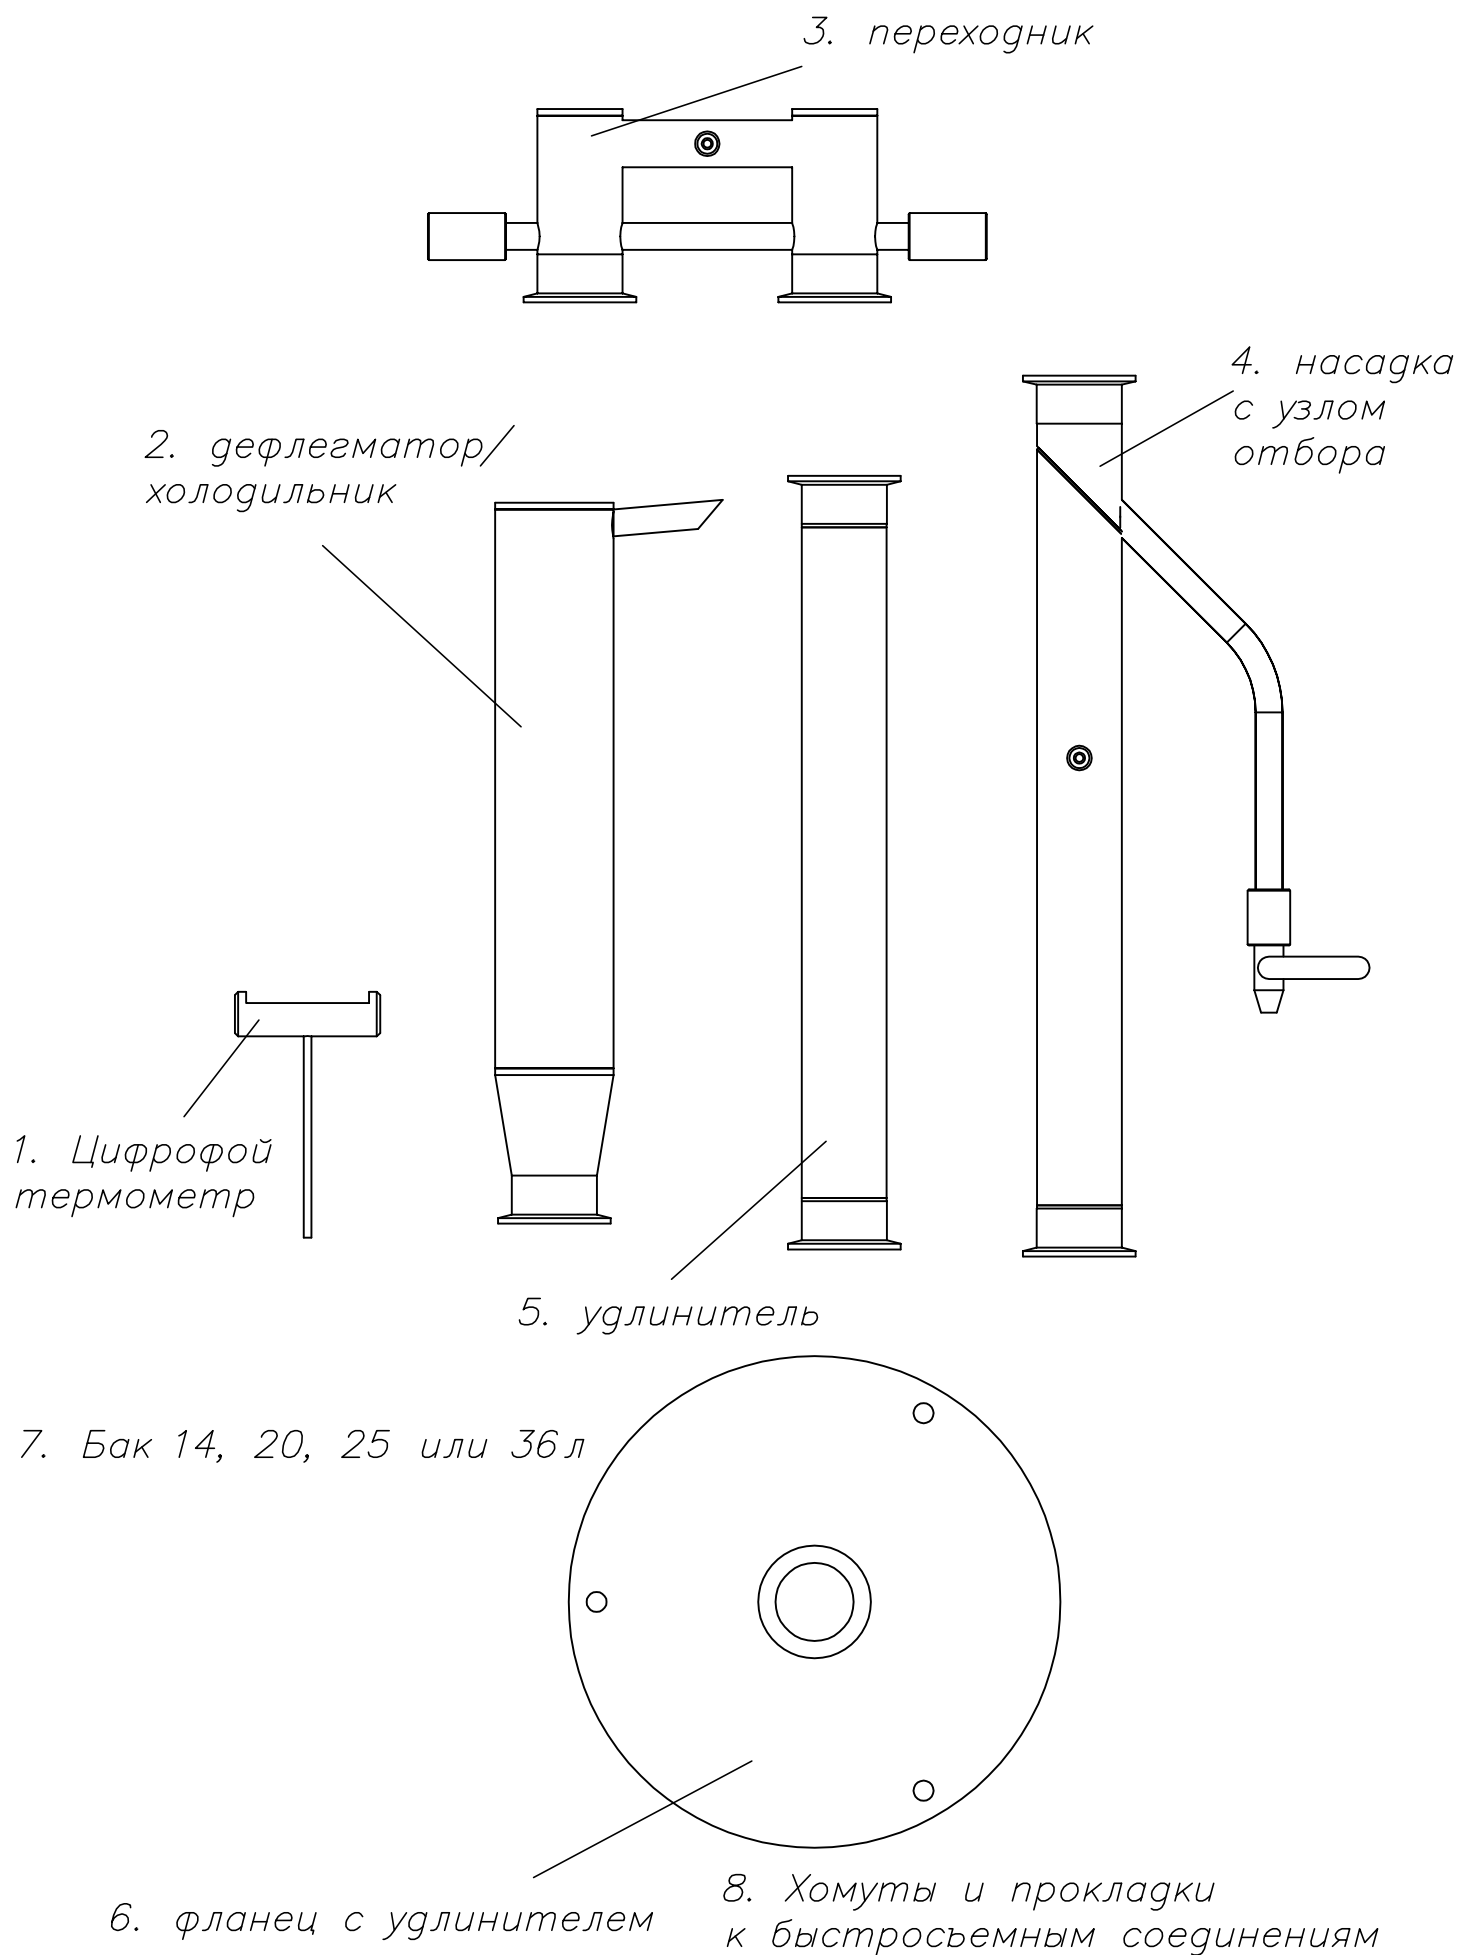


Универсальная система Доктор Губер модель "миджет"

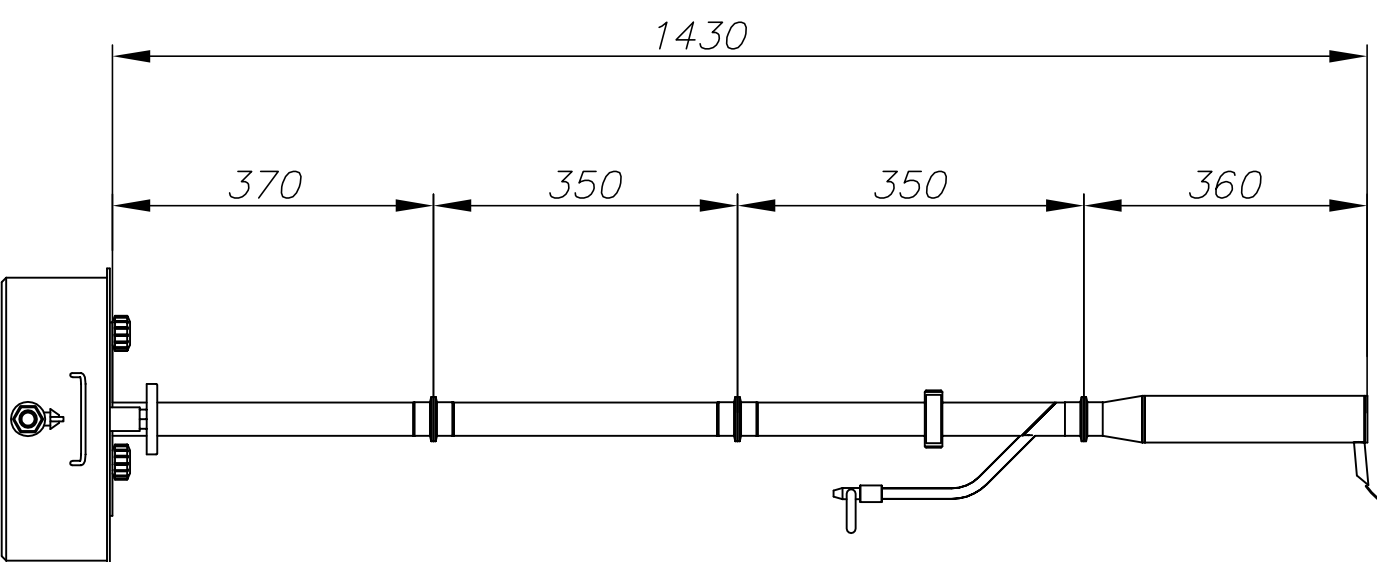

Режим ректификации (спирт 96.6 % об.)

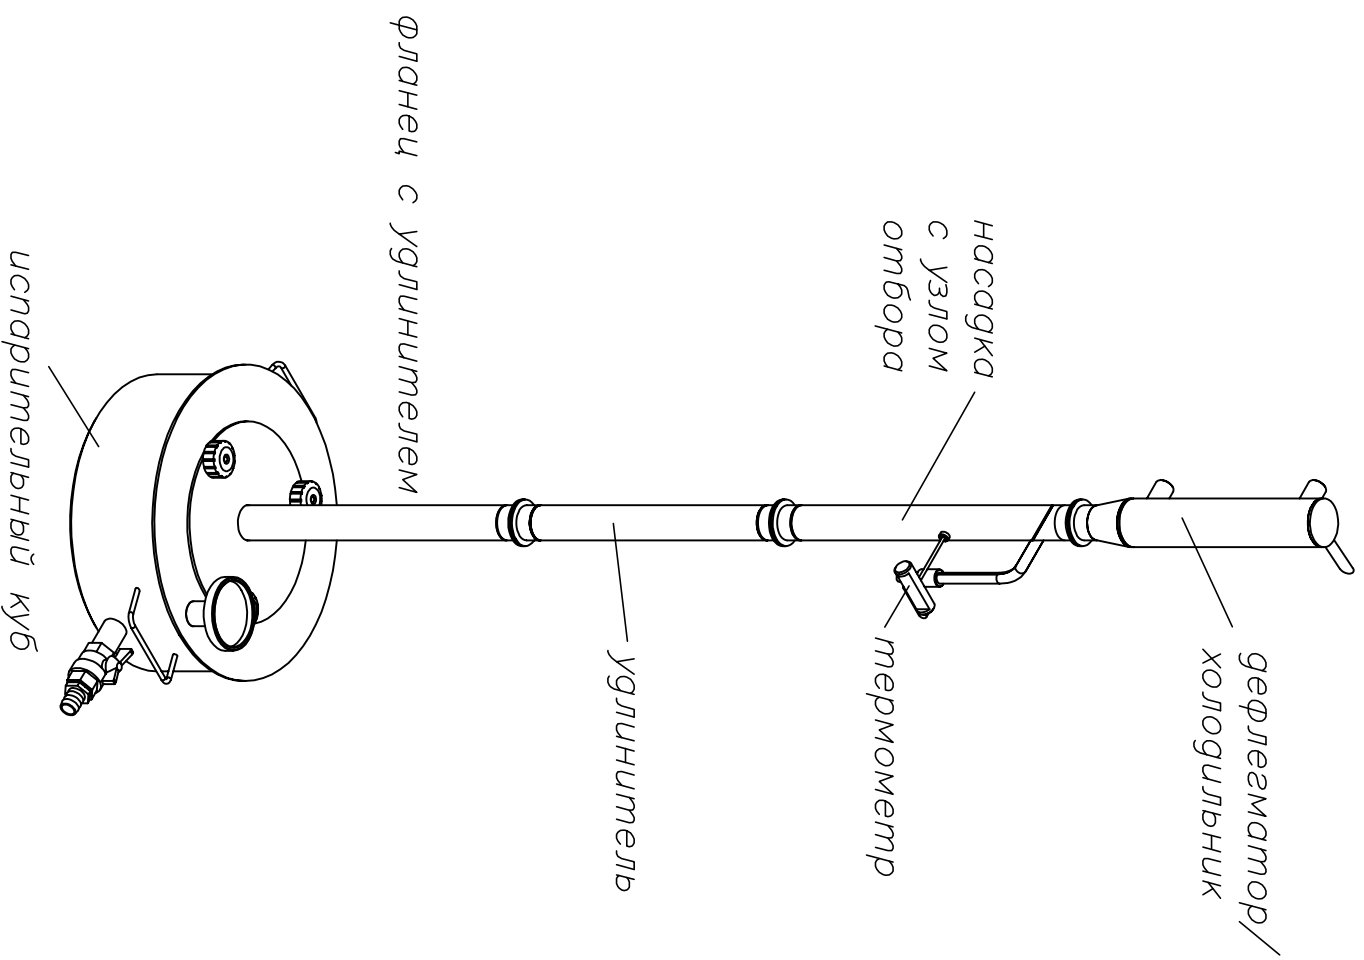

Режим дистилляции (70–85% об. спирта)

